


ДГИ1М.01.001 ЭЗ

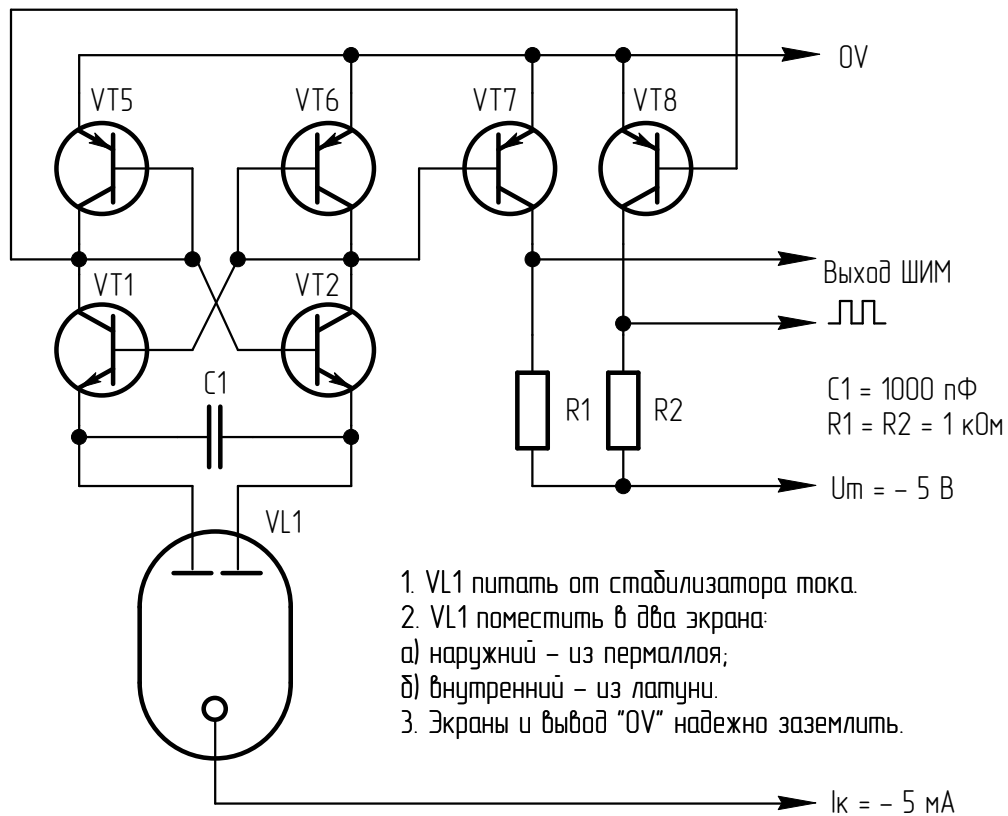

1. VL1 питать от стабилизатора тока.
2. VL1 поместить в два экрана:
 а) наружный – из пермаллоя;
 б) внутренний – из латуни.
3. Экраны и вывод "0V" надежно заземлить.

ДГИ1М.01.001 ЭЗ

Детектор супергамма
излучения ДГИ1М

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	1